
Катод E047 для анализатора 3G - 129108S / 114864S

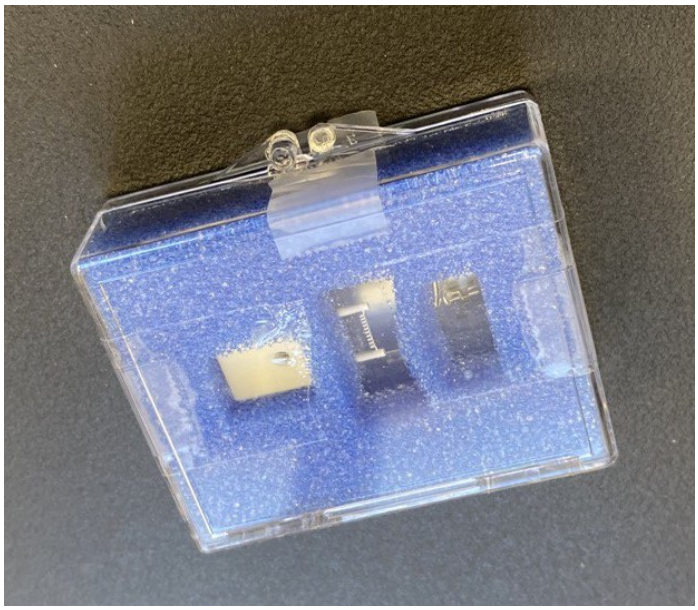


Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 1 шт.

Катод E047 для анализаторной ячейки 3G. На складе в Санкт-Петербурге - 1 шт. с обозначением 129108S. Возможность замены на 114864S проверяется по исполнению анализатора.

Запасные части · Анализаторные ячейки и нити накала

Катод 129108S для анализаторной ячейки 3G в защитном футляре.

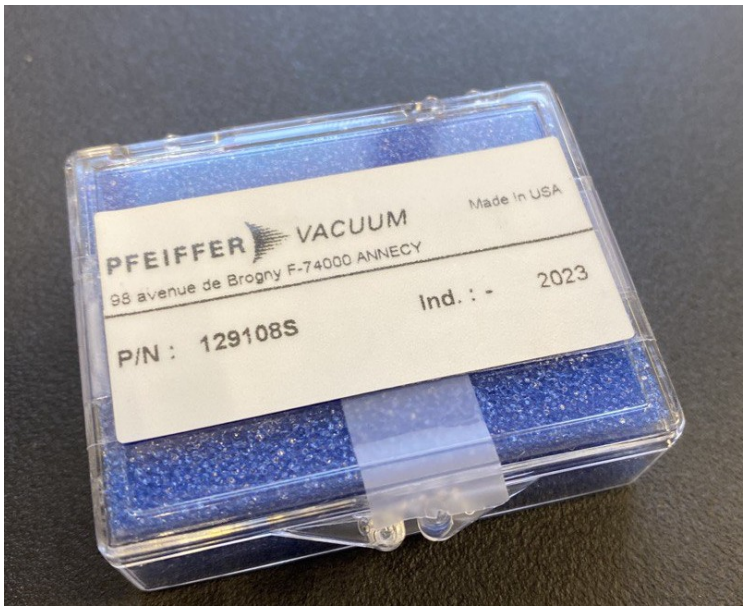

Заводская маркировка P/N 129108S на футляре катода.

Технические сведения и идентификация

Парт-номер в руководстве ASM 340	114864S
Позиция на схеме	E047
Заводское наименование	Filament for 3G Analyzer Cell
Номер из прежней заявки	129108S - соответствие конкретной ревизии необходимо подтвердить
Поколение	3G
Применение по проверенному руководству	Анализаторная ячейка ASM 340
Поставка	Лаборатория контроля герметичности Ликлаб, Россия

Роль в масс-спектрометрическом тракте

Нить формирует электронный поток для ионизации поступающего газа. Стабильная эмиссия необходима для воспроизводимого сигнала, но чувствительность прибора определяется состоянием всего измерительного и вакуумного тракта.

Как согласовать 129108S и 114864S

Обозначение E047 - позиция в документации, а не универсальный артикул для любого течеискателя. Руководство подтверждает 114864S для описанного ASM 340, но само по себе не устанавливает безусловную замену всех поставок 129108S. В заказе указывают оба известных номера, модель, S/N и маркировку ячейки.

Что проверить до ремонта

Необходимо различить обрыв нити, проблемы контактов, загрязнение изоляции и неисправность источника питания. Если прибор поддерживает выбор нити, фиксируют, на какой из них возникает ошибка. Это помогает избежать замены исправной детали.

Проверка восстановленного прибора

После работ контролируют герметичность ячейки, вакуум, стабильность фонового сигнала и калибровочный отклик. Параметры питания и положение элементов задают по сервисной документации установленного исполнения, а не по универсальным рекомендациям.

Поставка в России и заявка на подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб принимает заявки на поставку 114864S. Для согласования отправьте модель и серийный номер оборудования, фото шильдика и снятого узла, известный парт-номер, требуемое количество и город доставки. Происхождение, комплектность и документы конкретной партии фиксируются в предложении.

Цена и срок отгрузки согласуются при резервировании. Указанный остаток относится к дате подготовки карточки и может изменяться. Перед сервисными работами оборудование штатно останавливают; разборку выполняет подготовленный специалист по руководству производителя.

Запросить 114864S · +7 (812) 715-00-17

Pfeiffer: ASM 340, раздел F 500, позиция E047

Складское исполнение и комплектность

Катод для ячейки анализатора 3G. Совместимость сверяем по исполнению ячейки.

Поставка и техническая поддержка

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб помогает подобрать исполнение, проверить присоединения и комплектность. Для заявки укажите наименование, количество и параметры установки. Отгрузка со склада в Санкт-Петербурге согласуется после проверки свободного остатка.

Параметры давления, температуры, электрической нагрузки и ресурса, отсутствующие в таблице, определяются паспортом конкретного исполнения.

Карточка изделия и документы

https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2010-spare-filament-e047-3g-114864s

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка. lab@techeiscatel.ru